


РАЗВЕТВИТЕЛЬ МКСН.434641.025

Назначение:

Для объединения нескольких линий ЦДТ 1004 с датчиками (под словом "линия" подразумевается сеть с датчиками, установленными заказчиком самостоятельно), а также отдельных датчиков (например ЦДТ 1004) и подключения их к ПКЦД. Количество разъемов для подключения датчиков в зависимости от исполнения разветвителя приведено в таблице.

Примечание: Разветвитель не применяется для подключения нескольких термокос (МЦДТ 0922) к одному контроллеру. Для подключения нескольких термокос используется многоканальный контроллер (например СКЦД-6/200).

Обозначение	Количество разъемов XP
-00	2
-01	3
-02	4
-n*	m**
*n - порядковый номер исполнения разветвителя **m=n+2	

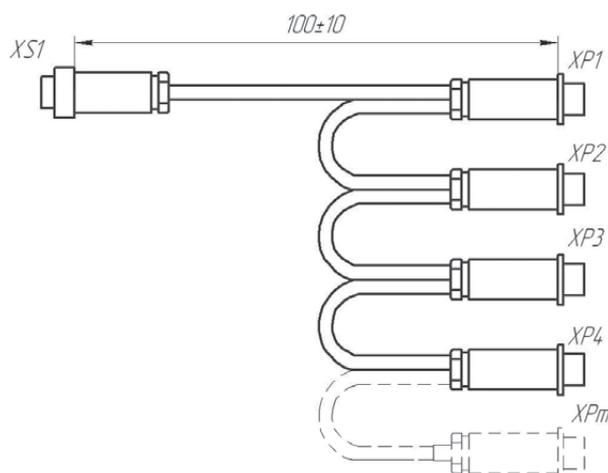


УДЛИНИТЕЛЬ МКСН.434641.032

Назначение:

Используется в случае, если ограничен доступ непосредственно к выходному разъему линии, датчика ЦДТ 1004 (вариант 1) или термокосы МЦДТ 0922 (вариант 2). Длины удлинителя и варианты входного разъема удлинителя приведены в таблице.

Примечание: Калибровка ЦДТ 1004 или МЦДТ 0922 проводится без удлинителя, при наращивании расстояния до разъема свыше 10 метров их погрешность может выйти за заявленные пределы на несколько десятых долей градуса. В этом случае необходимо заказать ЦДТ 1004 или МЦДТ 0922 с увеличенным расстоянием от разъема до датчика.

Обозначение	L, мм	Вариант
-00	1000	1
-01	1000	2
-02	2000	1
-03	2000	2
-04	5000	1
-05	5000	2
-06	130	2

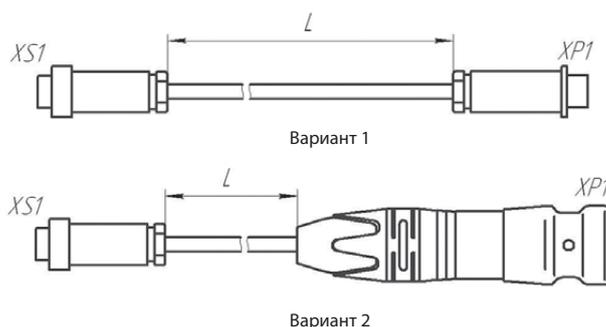


ПЕРЕХОДНИК МКСН.434641.033

Назначение:

Для подключения МЦДТ 0922 к ПКЦД.

Примечание: Переходник не используется, если подключение МЦДТ 0922 к ПКЦД осуществляется через удлинитель МКСН.434641.032 вариант 2 (переходник представляет собой укороченный МКСН.434641.032-01).

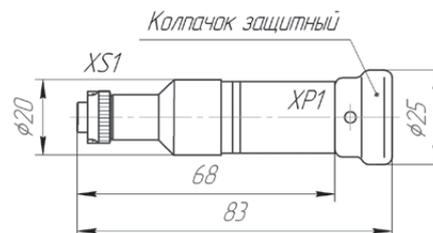

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,
Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12
www.omsketalon.nt-rt.ru || ots@nt-rt.ru